

6.7. Кнопки главного меню прибора:

- **MOD** – меню установки импульсной модуляции выходного сигнала;
- **SWEEP** – меню настройки выходного сигнала в режиме развёртки;
- **PRESETS** – меню для сохранения пользовательских настроек;
- **LEVEL** – установка уровня мощности выходного сигнала;
- **FREQ** – установка частоты выходного сигнала;
- **SETTINGS** – (кнопка в виде шестерёнки) – меню дополнительных настроек прибора.

7. Быстрый старт

- включите прибор;
- установите желаемую частоту выходного сигнала в меню **FREQ** или кнопками – и + на экране, перемещаясь по разрядам кнопками ← и →;
- в меню **LEVEL** или кнопками на экране установите уровень мощности выходного сигнала;
- подключите к разъёму **RF OUT** прибора исследуемое устройство. Включите подачу выходного сигнала, нажав кнопку **RF OFF / RF ON**;
- для тестирования исследуемого устройства сигналом с импульсной модуляцией, установите желаемые параметры в меню **MOD**. Подача сигнала с импульсной модуляцией производится кнопкой **MOD OFF / MOD ON** в меню **MOD**;
- для вывода сигнала в режиме развёртки произведите установки в меню **SWEEP**;
- сохраните настройки прибора в меню **PRESETS**;

Все технические характеристики и полное руководство по эксплуатации приборов в формате PDF размещены на нашем сайте www.kroks.ru

В связи с постоянным совершенствованием прибора и программного обеспечения, производитель оставляет за собой право вносить изменения в его технические характеристики и комплектность.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- гарантинный срок изделия со дня продажи истек;
- отсутствуют документы подтверждающие дату и факт покупки изделия;
- изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось для осуществления коммерческой деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой Покупателю в комплекте с изделием;
- при наличии в Товаре следов неквалифицированного ремонта или попыток вскрытия вне авторизованного сервисного центра, а также по причине несанкционированного вмешательства в программное обеспечение;
- повреждения (недостатки) Товара вызваны воздействием вирусных программ, вмешательством в программное обеспечение, или использованием программного обеспечения третьих лиц (неоригинального);
- дефект вызван действием непреодолимых сил (например, землетрясение, пожар, удар молнии, нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умышленными, или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- механические повреждения (трещины, сколы, отверстия), возникшие после передачи изделия Покупателю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- дефект возник из-за подачи на входные разъёмы, клеммы, корпус сигнала или напряжения или тока, превышающего допустимые для данного Товара значения;
- дефект вызван естественным износом Товара (например, но, не ограничиваясь: естественный износ разъёмов из-за частого подключения/отключения переходников).

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем или авторизованным сервисным центром.

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись Покупателя)

2191 2192



ООО «Крокс Плюс»
394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263
+7 (473) 290-00-99
info@kroks.ru
www.kroks.ru

Генераторы сигналов

ARINST ArSiG-S и ARINST ArSiG-R

с автономным источником питания



Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия

1. Назначение


1.1. Портативные генераторы сигналов ARINST ArSiG-S и ARINST ArSiG-R предназначены для формирования высокочастотных сигналов в диапазоне 1-6200 МГц. Приборы способны осуществлять развёртку выходного сигнала, как по частоте, так и по уровню. Генераторы имеют возможность использовать внешний высокостабильный источник сигнала в качестве опорного.

1.2. Генератор ARINST ArSiG-S является генератором синусоидальных колебаний во всем диапазоне рабочих частот. Генератор ARINST ArSiG-R в диапазоне частот до 3000 МГц формирует колебания прямоугольной формы. В диапазоне 3000-6200 МГц прибор формирует синусоидальные колебания.

1.3. Приборы предназначены для радиолюбительского применения, так как не являются профессиональными средствами измерения. Наличие встроенного аккумулятора позволяет производить измерения в лабораторных и полевых условиях.

1.4. Приобретая генератор, проверьте его комплектность. **Внимание! После покупки прибора претензии по некомплектности не принимаются!**

2. Устройство прибора

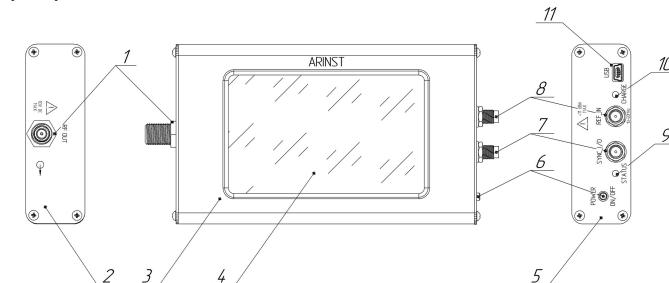

1. Выходной ВЧ разъём **RF OUT**
2. Панель торцевая левая
3. Корпус прибора
4. Цветной резистивный экран 4"
5. Панель торцевая правая
6. Мультифункциональная кнопка
7. Вход/выход сигнала синхронизации **SYNTH I/O (Триггер)**
8. Вход внешнего опорного сигнала **REF IN**
9. Индикатор **STATUS**. Святится, когда прибор включен
10. Индикатор **CHARGE**. Святится во время зарядки аккумулятора
11. Разъём **mini-USB**. Служит для передачи данных и зарядки аккумулятора прибора

3. Комплект поставки

	ArSiG-S	ArSiG-R
Генератор сигналов ARINST ArSiG-S	1 шт.	--
Генератор сигналов ARINST ArSiG-R	--	1 шт.
Переходник SMA(female)-SMA(female) для защиты разъемов от износа	2 шт.	2 шт.
Кабель USB2.0 –mini-USB	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 экз.	1 экз.
Упаковка	1 шт.	1 шт.
Артикул	2191	2192

4. Технические характеристики

Параметры	Значение	
	ArSiG-S	ArSiG-R
Диапазон рабочих частот	1-6200 МГц	
Погрешность уровня выходной мощности ¹	± 1 дБ	
Разрешение по частоте	3 кГц	
Шаг установки уровня выходной мощности	0,1 дБ	
Фазовый шум на частоте 1 ГГц (при отстройке 100 кГц)	-95,2 дБн/Гц	-110,1 дБн/Гц
Номинальный уровень выходной мощности	+10 дБм	
Минимальный уровень выходной мощности	1-50 МГц 50-100 МГц 100-3000 МГц 3000-5500 МГц 5500-6200 МГц	-5 дБм -20 дБм 0 дБм -10 дБм -10 дБм -20 дБм -20 дБм
Выходное сопротивление	50 Ом	
Максимальное постоянное напряжение на входе	+25 В	
Максимальная мощность входного сигнала	+10 дБм	
Число запоминаемых пользовательских настроек	10	
Число запоминаемых элементов развертки в каждом списке	50	
Рабочий диапазон температур	0 ... +40°C	
Диагональ экрана	4"	
Тип экрана	сенсорный, резистивный	
Разрешение экрана	800×480	
Тип разъёма выходного порта	SMA (female)	
Внешний источник опорного сигнала		
Тип разъёма	SMA female	
Диапазон входных частот	10-40 МГц	
Уровень входного сигнала	максимальный рекомендуемый	+13 дБм +5 ... +10 дБм
Входное сопротивление	50 Ом	
Внешний триггер		
Тип разъёма	SMA female	
Максимальное входное напряжение	+3,3 В	
Энергопотребление и габариты		
Напряжение питания	5 В	
Потребляемая мощность	3,7 Вт	3 Вт
Максимальный потребляемый ток, не более	при зарядке аккумулятора ² при работе от USB с зарядкой аккумулятора ³	≤2 А ≤2 А
Ёмкость аккумулятора	5000 мАч	
Время непрерывной работы от аккумулятора ⁴	4,5 ч	5,5 ч
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	150×81×27 мм	
Масса	0,4 кг	

¹ После прогрева прибора продолжительностью не менее пяти минут. Изменение температуры окружающей среды от момента прогрева прибора до проведения измерений не должно превышать ±3 °C.

² При подключении прибора к зарядному устройству с выходным током не менее 3 А.

³ Если ваше устройство имеет ограничение по максимальному току, подаваемому на порт USB, прибор автоматически ограничит максимальный ток зарядки в соответствии с текущей спецификацией USB.

⁴ При температуре окружающей среды плюс 20±5°C после полного заряда аккумулятора.

5. Включение прибора

⚠ Внимание! Использование прибора на открытых пространствах во время снегопада или дождя запрещается. Если прибор внесен в зимнее время из холодного помещения или с улицы в теплое помещение, не включайте его в течение времени достаточного для испарения конденсата из прибора.

5.1. Убедитесь в том, что прибор не имеет внешних повреждений и аккумулятор заряжен. Разряженный аккумулятор зарядите перед использованием прибора. При подключении зарядного устройства происходит автоматическое определение максимального тока зарядки. Для уменьшения времени зарядки аккумулятора рекомендуется использовать в качестве зарядного устройства промышленные блоки питания (зарядные устройства) с максимальным выходным током 3 А. По завершению зарядки индикатор (10) CHARGE погаснет.

Допускается работа прибора во время зарядки аккумулятора при условии, что источник питания способен обеспечить выходной ток не менее 1500 мА. В случае если зарядное устройство или USB-порт ПК не способны обеспечить требуемый для работы устройства и зарядки аккумулятора ток, устройство будет автоматически понижать потребляемый ток вплоть до полного прекращения зарядки аккумулятора.


5.2. Нажмите и удерживайте кнопку (6) около 2 секунд. Включение прибора подтверждается включением индикатора (9) STATUS.

5.3. В приборе реализована функция выключения экрана для экономии заряда аккумулятора. Для выключения экрана (4) дважды нажмите кнопку (6). Прибор продолжит работу с выключенным экраном. Для включения экрана, однократно коснитесь его в любом месте.

⚠ Внимание! Соотносите мощность сигнала и напряжение, подаваемое на порты с максимальными техническими характеристиками прибора, указанными в таблице.

5.4. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку (6) около 2 секунд. Экран прибора погаснет, прибор выключится. При каждом выключении прибора осуществляется запись текущих пользовательских настроек в энергонезависимую память, что позволяет избежать настройки прибора при последующем включении.

6. Экран прибора

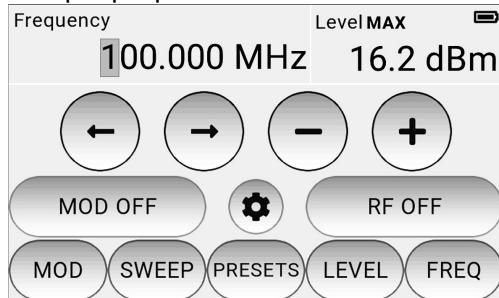

Информация на экране прибора

батареи – аккумулятор разряжен, необходимо его зарядить;

- прибор вывел на экран сообщение о критическом уровне заряда – аккумулятор полностью разряжен, прибор автоматически выключится.

6.3. Частота сигнала (Frequency):

- отображается заданная пользователем частота сигнала. Установка частоты осуществляется в диапазоне 1-6200 МГц.

6.4. Уровень мощности сигнала (Level):

- отображается установленный уровень мощности выходного сигнала в дБм (dBm), дБв (dBv) и дБмкВ (dBmV);
- максимально возможный уровень мощности сигнала с заданными параметрами. Отображается символом MAX. Данная индикация говорит о том, что дальнейшее увеличение мощности для текущей частоты невозможно.

6.5. Под информационными областями расположены интерактивные кнопки управления интерфейсом:

- ← и → – перемещение курсора по разрядам устанавливаемого значения частоты или уровня мощности выходного сигнала;
- – и + – уменьшение или увеличение значения частоты или уровня мощности выходного сигнала.

6.6. Функциональные кнопки:

- MOD OFF / MOD ON – выключена / включена модуляция сигнала;
- RF OFF / RF ON – выключена / включена подача выходного сигнала на ВЧ разъём RF OUT.